





XRD CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-059
İlk Yayın Tarihi	28.04.2012
Revizyon Tarihi	02.06.2014
Revizyon No	02
Sayfa	1/1

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	28.04.2012	İlk yayın.
01	01.11.2013	Kodlama sistemi değişti.
02	02.06.2014	Talimatta genel değişiklik yapıldı.

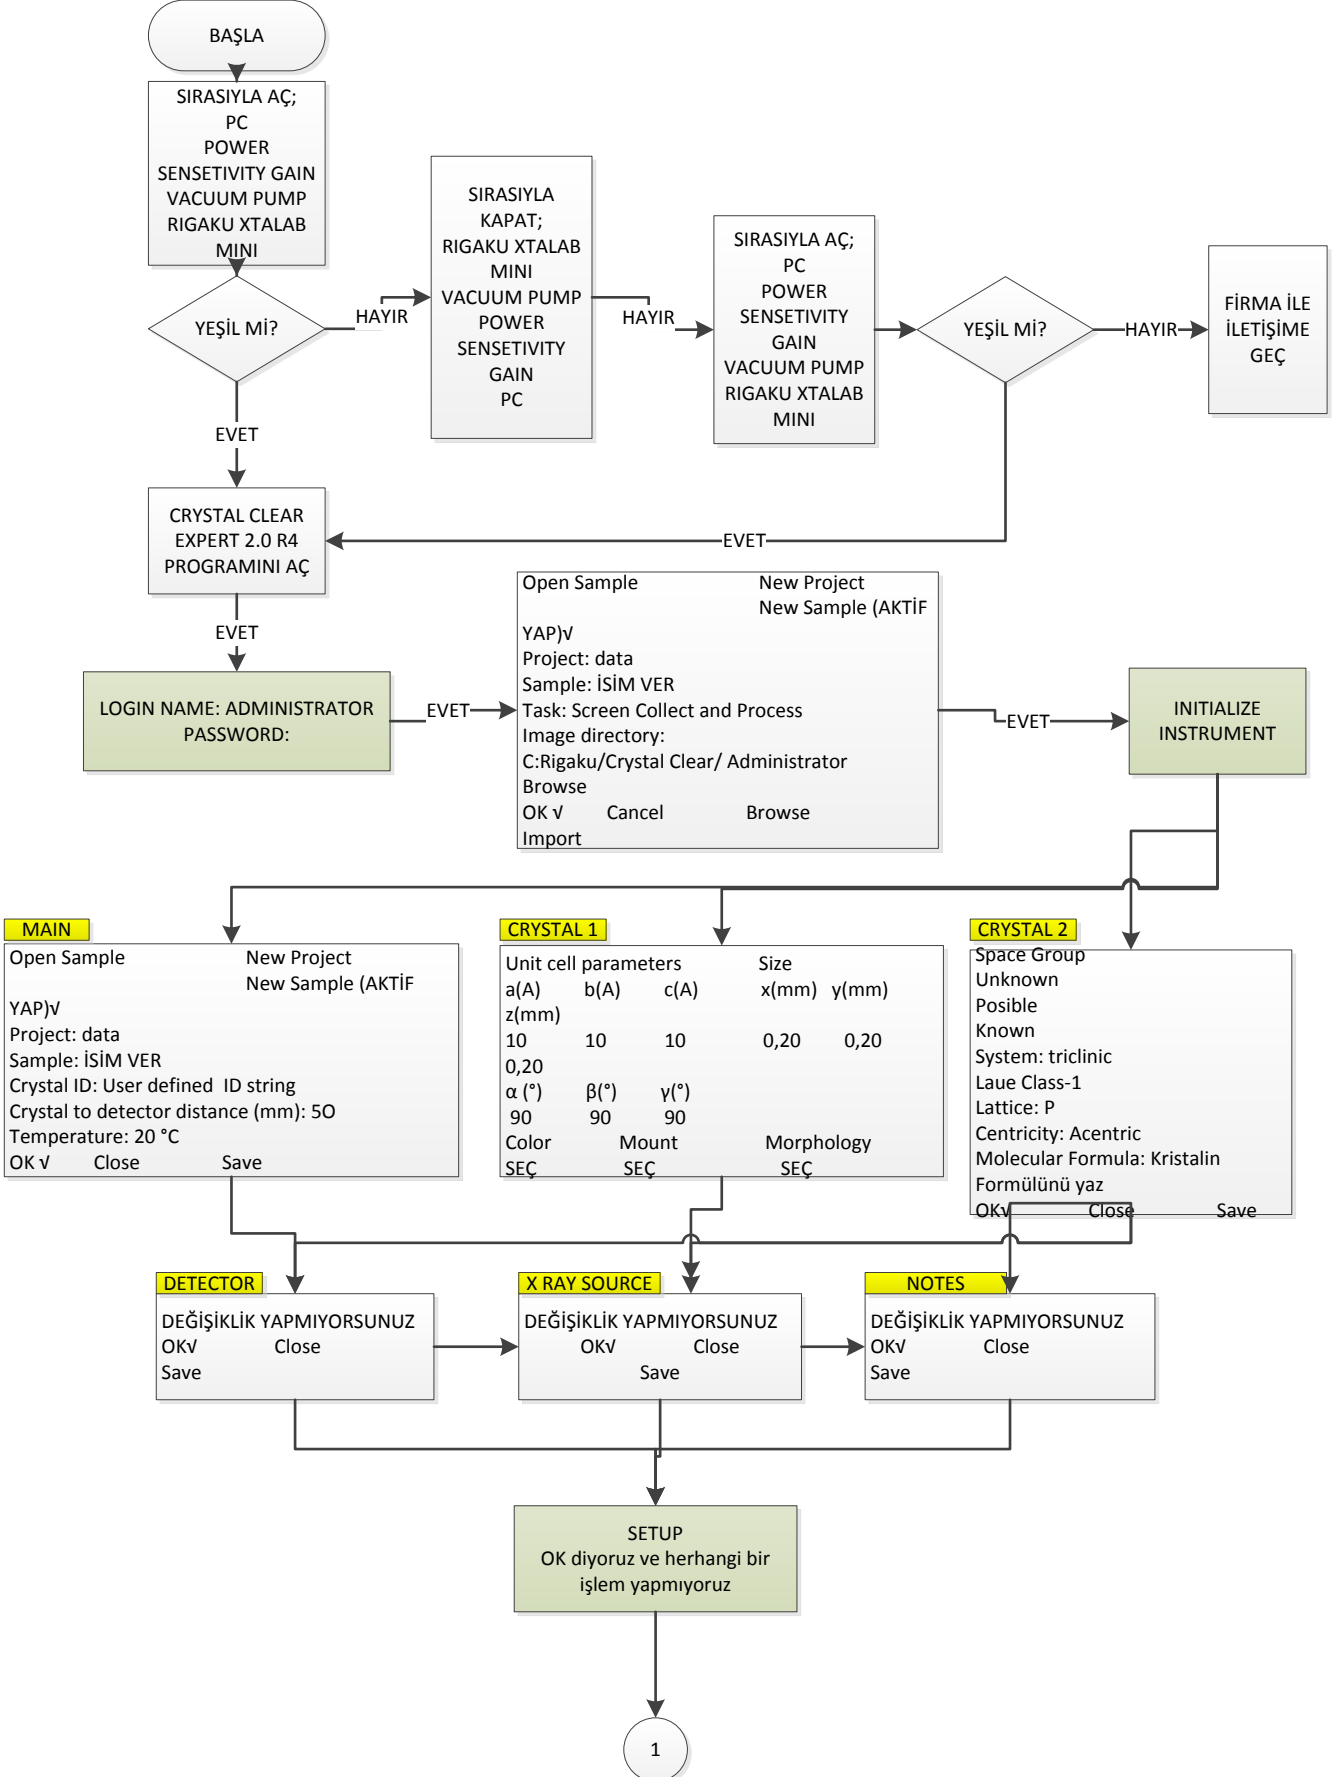

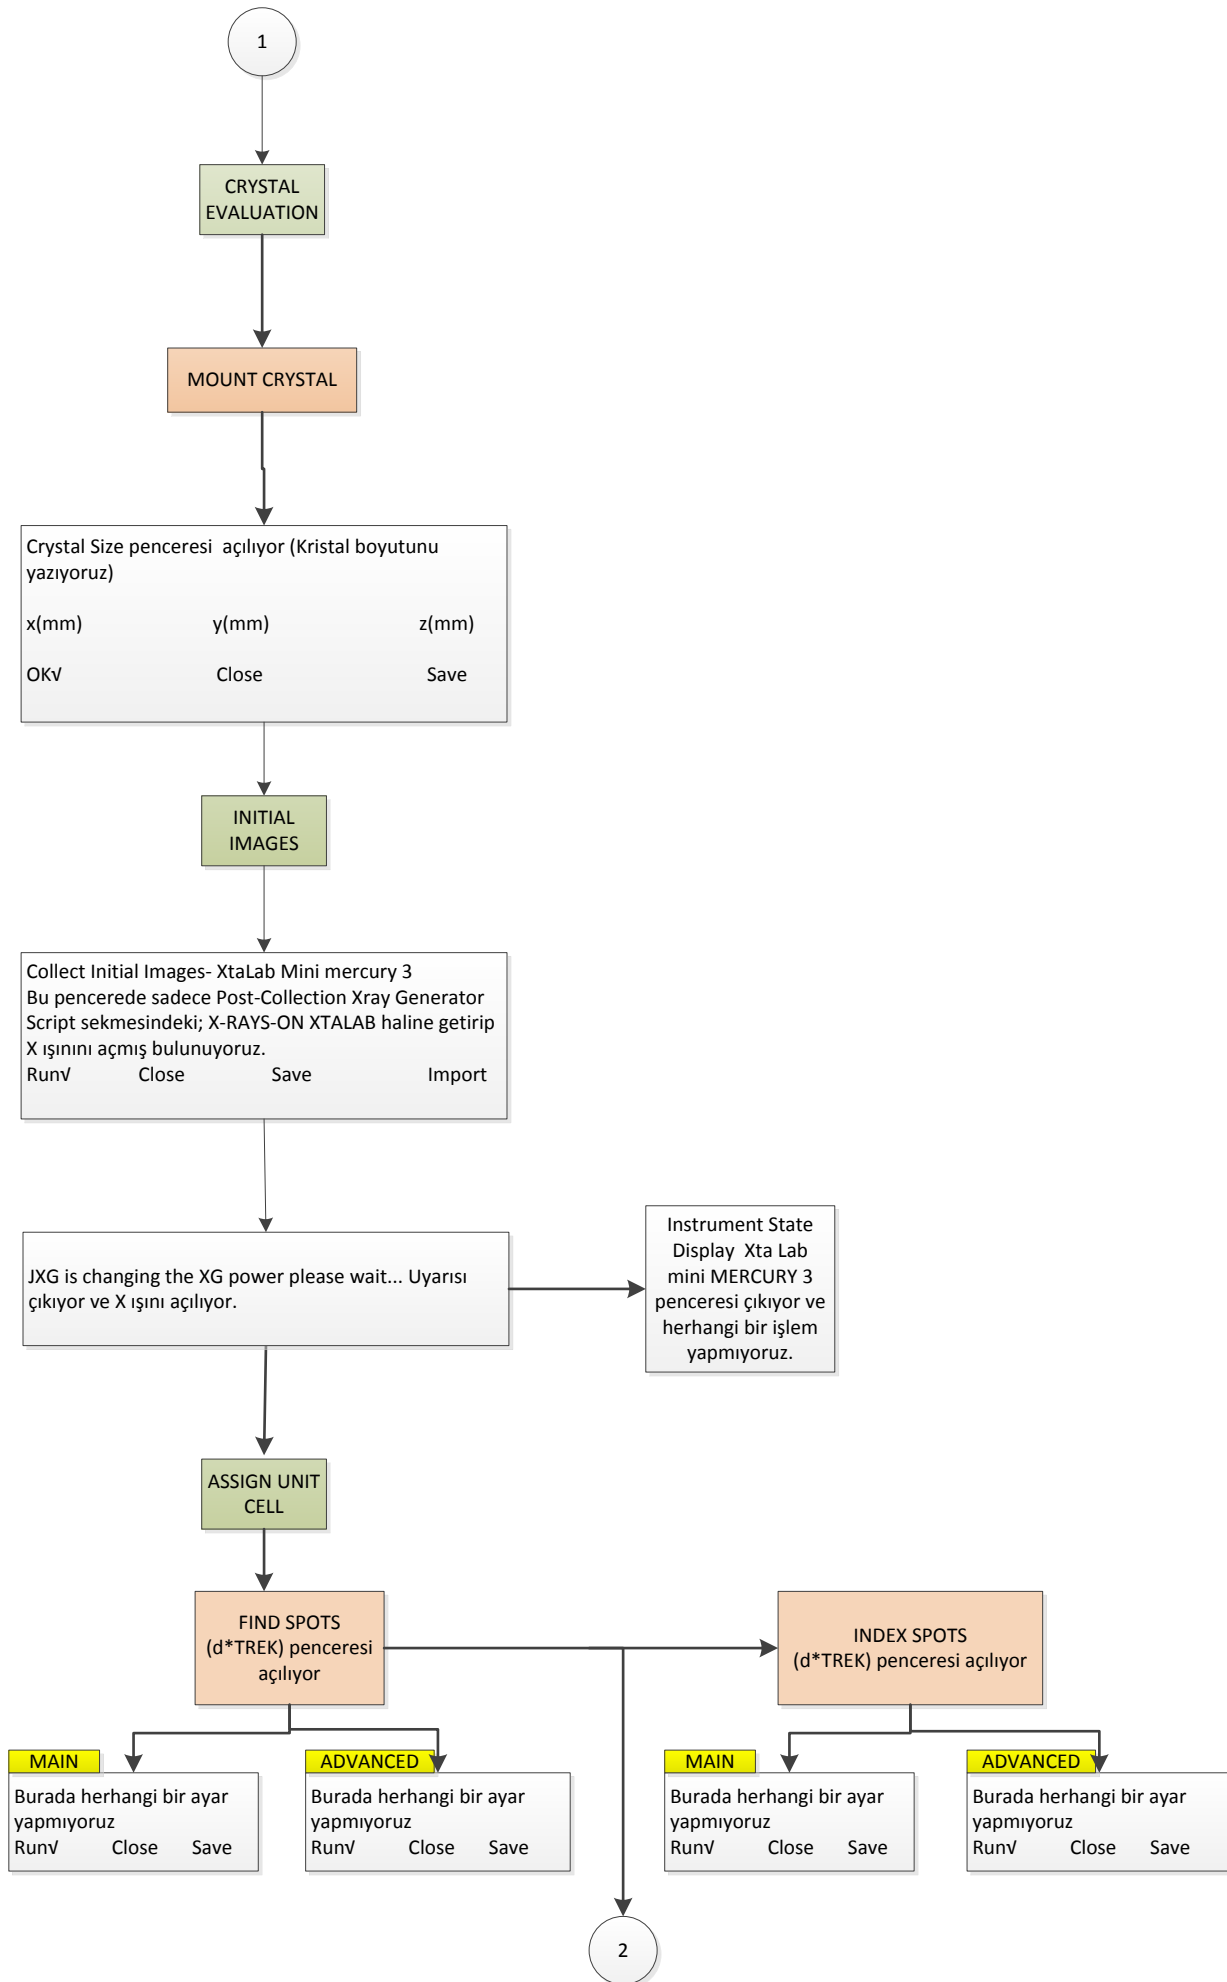

2

Processing State Display penceresi açılıyor; bir değişiklik yapıyoruz

Refine Primitive Cell
RunV Close Save
 Δ/σ 0.00 olana kadar run tuşuna basılır. 0.00
oldukta sonra close sekmesine basılır.

REDUCE CELL

REFINE STANDART
CELL

PREDICT SPOTS
RunV Close Save

STRATEGY ((d*TREK) penceresi açılıyor
RunV Close Save

COLLECT IMAGES
RunV Close Save Import

INTEGRATE REFLECTIONS
RunV Close Save Import

LAUE CHECK

NUM. ABS. CORRECTION

SCALE and ABSORPTION

FINAL REFINE CELL

SOLVE STRUCTURE